

National Iranian Copper Industries Co
Shahr Babak Copper Complex



Mines And Industries Ministry
Test Result Report
Date & No : 98/04/05

Test Subject :
Client Reference : مجتمع مس ایرانیاک

ANAL YAST DIVISION :WET,XRF

MEASURING UNIT		%	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	PPM	
SAMPLENO.	SAMPLE NAME	Cu% Calculated Included OXYGEN	Sn	Zn	Pb	Fe	Ni	P	Si	Mn	S	Cd	Bi	Cr	Sb	As	Se	Te	Ag	Co
CHD-980331	کس	99.998	<1	<2	<1	<1	<1	<1	<1	<0.2	2.74	<0.2	<0.6	<1	1.38	<1	<0.4	<1.2	<0.2	<2
CHD-980402	کس	99.998	<1	<2	<1	2.52	<1	<1	<1	<0.2	3.39	<0.2	<0.6	<1	<1	<1	<0.4	<1.2	<0.2	<2

LQS - F60 - 01

مجتمع مس شهر بابک
امور کنترل فرآیند و
برنامه ریزی تولید



شرکت ملی صنایع مس ایران مجمع مس شهربابک

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
شماره: ۹۸/د/۱۲۲/۲۸۱۸۳
پیوست: دارد

« به نام خدا »


مدیر محترم مجتمع شرکت بابک مس ایرانیان

موضوع: تایید نتایج آزمون های انجام شده توسط آزمایشگاههای این امور

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار می رساند که امور کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید مجتمع مس شهربابک از دو واحد اصلی ۱- کنترل کیفی ۲- آزمایشگاه ها تشکیل شده است ، لذا کلیه کارها و خدمات صورت گرفته در این دو واحد مورد تایید امور می باشند.
(در ضمن چارت سازمانی مصوب و تایید شده تشکیلات به پیوست می باشد .)

حسن زین الدینی کلاب
سرپرست امور کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید







شرکت ملی صنایع مس ایران

نمودار سازمانی کنترل فرایند و برنامه ریزی تولید مجتمع مس شهربابک

تعداد سازمانی : ۱۲۸

تاریخ اجرا : ۹۸.۵.۹

تهیه کننده : تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

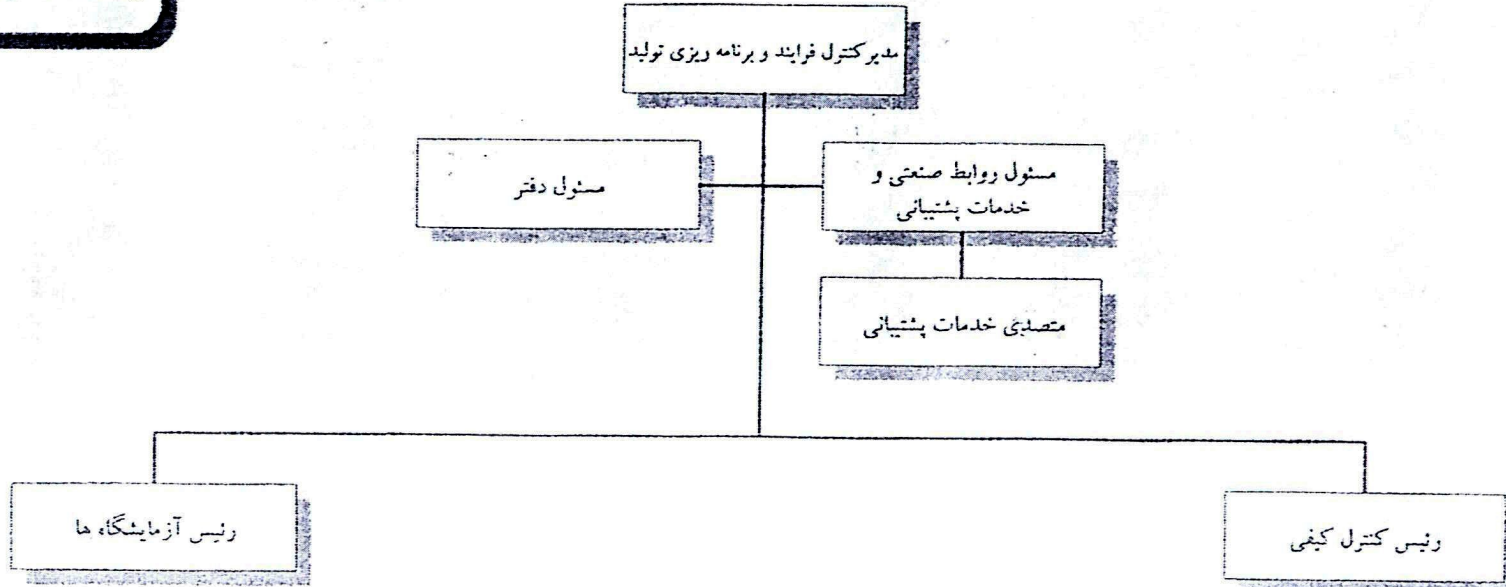

توضیح : پستهای کانتر بارت صرفاً به منظور جابگزینی کارکنان جدیداً استخدام طراحی گردیده است و متصدیان این پست ها پس از کسب تجربیات لازم بر اساس ضوابط مربوطه در پست های مرتبط جابگزین خواهند گردید.

تأیید کننده :

تصویب کننده :